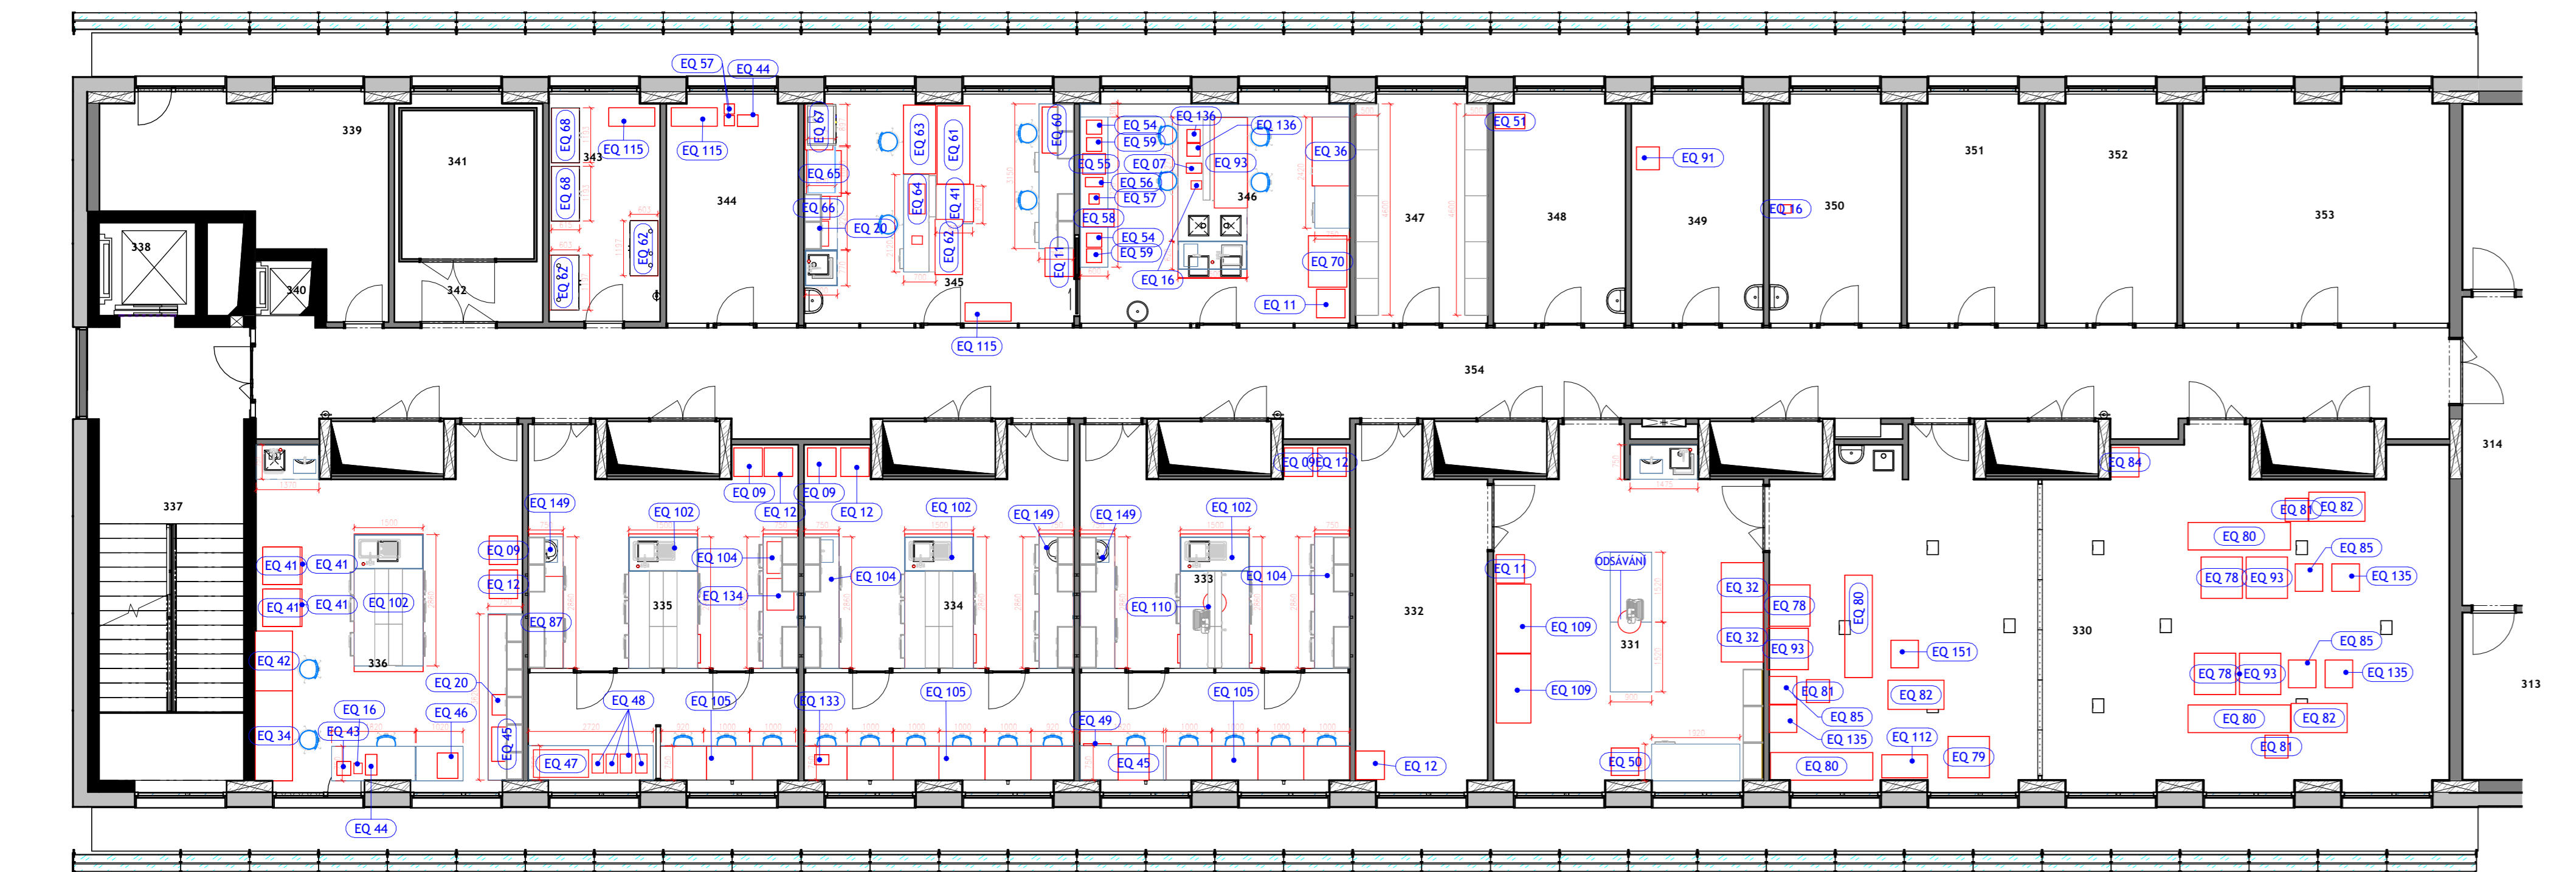


1 : 100

[illegible][illegible]

LABORATORNÍ NÁBYTEK 3NP

LABORATORNÍ NÁBYTEK

145

PRŮMYSLOVÁ

Celo státní dodání : / a / Název : *Síňka / Houdka / Výška : KS*

18 / Dávkové rozptyly se sadami : 18 / 1000 : 867 / 1

19 / Síňka laboratorní instalace karmosinová na soklu, pro práci ve stojce, dřevě bne zámků (bez potisku), fabrikát, dřevořez / 750 / 570 / 870 / 1

20 / Dávkové rozptyly se sadami : 18 / 1000 : 867 / 1

21 / Dávka pracovní, keramika, 15, 28 mm / 1000 : 700 / 28 / 0,77

22 / Výška karmosinová pro podlahu : přídavné (typ) 380 / 380 / 250 mm, bílá / 470 / 265 / 1

23 / keramika laboratorní spojovací - SMOZKOV, VODA, s keramickými kámy, G14+ / 0 / 250 / 300 / 1

24 / Společná bezpečnostní obložení a jednoboková, uloženo vloží obložení typové, v sestavě pro upevnění do pracovní desky dle 0 / 0 / 0 / 1

25 / Síňka nástěnná dřevěná, dřevě plně bne zámků (jedna potiska), dřevořez / 750 / 570 / 140 / 1

60 / Síňka laboratorní : 1200 / 700 / 900 / 1

18 / Dávkové rozptyly se sadami : 18 / 1000 : 867 / 1

19 / Síňka laboratorní závesná na soklu, pro práci ve stojce, čtyři záložky, horní záveska bne zámků / 600 / 570 / 870 / 1

20 / Síňka laboratorní závesná na soklu, pro práci ve stojce, čtyři záložky, horní záveska bne zámků, jednoboková / 600 / 570 / 870 / 1

21 / Dávkové rozptyly se sadami : 18 / 1000 : 867 / 1

22 / Dávka pracovní, keramika, 15, 28 mm / 1000 : 700 / 28 / 1,22

23 / Síňka nástěnná dřevěná, dřevě plně bne zámků (jedna potiska), jednoboková / 600 / 350 / 140 / 1

24 / Síňka nástěnná dřevěná, dřevě plně bne zámků (jedna potiska), jednoboková / 600 / 350 / 140 / 1

001 / Na skladování reperi : 1000 / 600 / 1700 / 1

002 / Síňka skladovací reperi, reperi, 4 potisk, prosklávané dřevo / 1000 / 600 / 1700 / 1

003 / Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení sálků pod digitální, bezpečnostní sálků, ... vypočtené vzduchotechniky / 1000 / 75 / 0 / 1

0240 / 949 / na hořlavost

0241 / Sálky bezpečnostní na hořlavost - řada G, typ 90 - dřevořez / 893 / 453 / 1953 / 1

044 / Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení sálků pod digitální, bezpečnostní sálků, ... vypočtené vzduchotechniky / 1000 / 75 / 0 / 1

0000 / Síňka laboratorní : 2100 / 700 / 900 / 1

001 / Konstrukce typ H (mátrná), pro práci ve stojce, bne pracovní desky / 900 / 545 / 870 / 1

002 / Zákrutky a (odmátnutí) pro n.P.S. 900/870 / 0 / 0 / 0 / 1

003 / Konstrukce typ H (mátrná), pro práci ve stojce, bne pracovní desky / 1000 / 545 / 870 / 1

004 / Zákrutky a (odmátnutí) pro n.P.S. 1200/870 / 0 / 0 / 0 / 1

005 / Konstrukce závesná na soklech (2 křídla), čtyři záložky a (odmátnutí), dotahem a (mátrná) bne (tisková), centrální záskl a (biská) / 430 / 585 / 620 / 1

006 / Síňka pro norní měřící kování - typ sloupky (stojící na podstavě, jednoramenná bne vanký, 2 polce (typ) 100x100 12x100 mm / 900 / 150 / 1620 / 1

007 / Síňka pro norní měřící kování - typ sloupky (stojící na podstavě, jednoramenná bne vanký, 2 polce (typ) 100x100 12x100 mm / 1200 / 150 / 1620 / 1

008 / Slavné zábr pro měřící ústí (dávky) / 1000 / 0 / 0 / 1

009 / Slavné zábr pro měřící ústí (dávky) / 1000 / 0 / 0 / 1

010 / Slavné zábr (dávky) 243/200 - měřící ústí (typ sloupky) / 0 / 0 / 0 / 2

011 / Slavné zábr (dávky) 243/200 - měřící ústí (typ sloupky) / 0 / 0 / 0 / 2

012 / Dávka pracovní, keramika, 15, 28 mm / 1000 : 600 / 28 / 2,12

0000 / Síňka laboratorní : 820 / 800 / 900 / 1

001 / Konstrukce typ H (mátrná), pro práci ve stojce, bne pracovní desky / 870 / 545 / 870 / 1

002 / Dávka pracovní, keramika, 15, 20 mm (typ) 100x100 12x100 mm (typ) 100x100 12x100 mm / 1000 : 800 / 15 / 1

0000 / Síňka laboratorní : 750 / 700 / 900 / 1

001 / Konstrukce typ H (mátrná), pro práci ve stojce, bne pracovní desky / 870 / 545 / 870 / 1

002 / Dávka pracovní, keramika, 15, 28 mm (typ) 100x100 12x100 mm (typ) 100x100 12x100 mm / 1000 : 750 / 15 / 1,75

0000

0001 / Síňka laboratorní vyřezaná, kolenné opěrky, výškové stativky a optickým chromovým křemem, kolenné, kolenné pro tvrdé povrchy 0+0+0+0+4

LABORATORNÍ NÁBYTEK 3NP

LABORATORNÍ NÁBYTEK

[illegible][illegible]